Equipments

☆使用希望の方、ご連絡ください！

装置名	仕様	
デジタルマイクロスコープ	VHX-900 KEYENCE 5000 倍の光学顕微鏡観察・ 偏光観察	

表面張力計	CBVP-A3 協和界面科学株式会社	
自動表面張力計 （物質化学科共通機器）	DY-300 協和界面科学株式会社	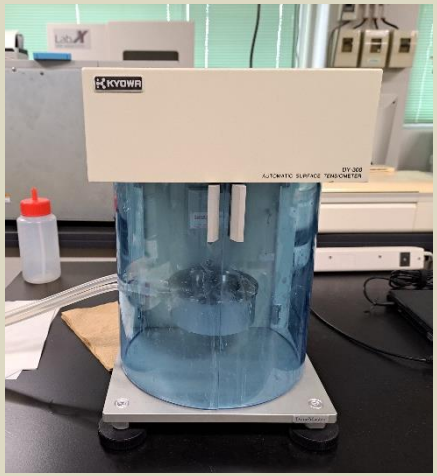

動的表面張力計	BP-D5L 協和界面科学株式会社	
自動接触角計 （物質化学科共通機器）	DM-701 協和界面科学株式会社	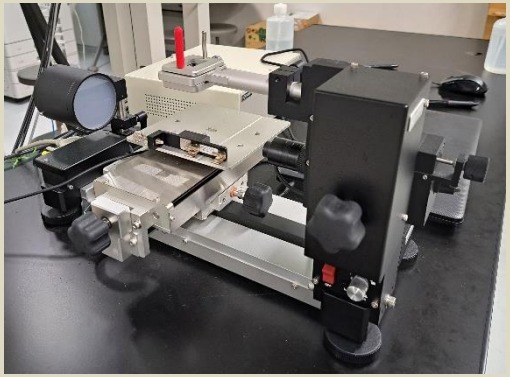

紫外可視分光光度計	U-1900 Spectrophotometer HITACHI 製	
	V-630 日本分光製	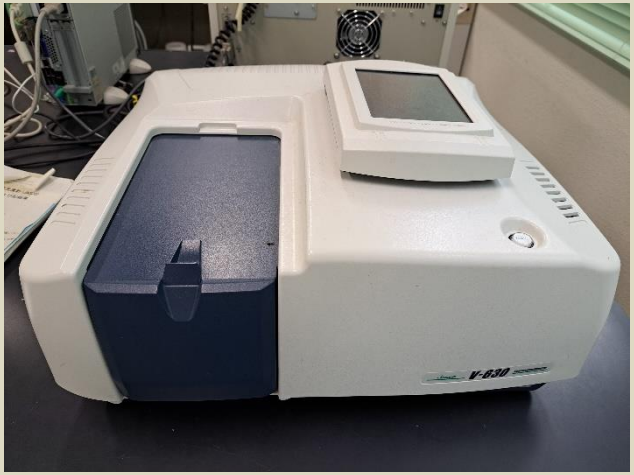

分光蛍光光度計	EP-6200ST 日本分光製	
赤外分光光度計	FT/IR-4600 日本分光製	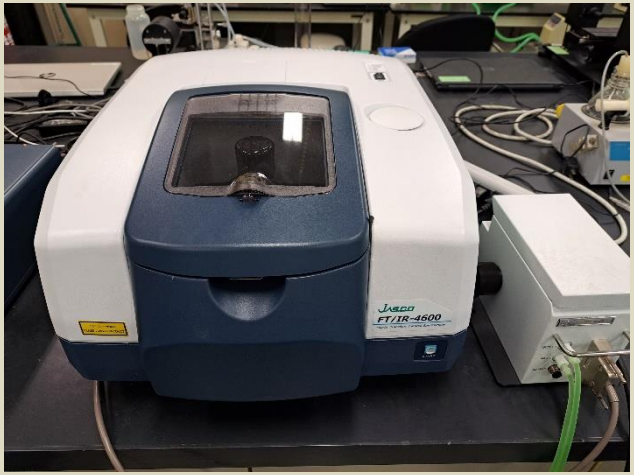

高速液体クロマトグラフィー	PU-4580/UV-4570 日本分光製	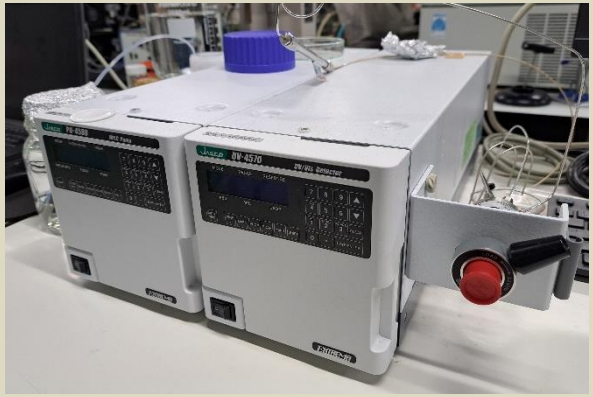
粒度分布計 （物質化学科共通機器）	LA-950 HORIBA 製	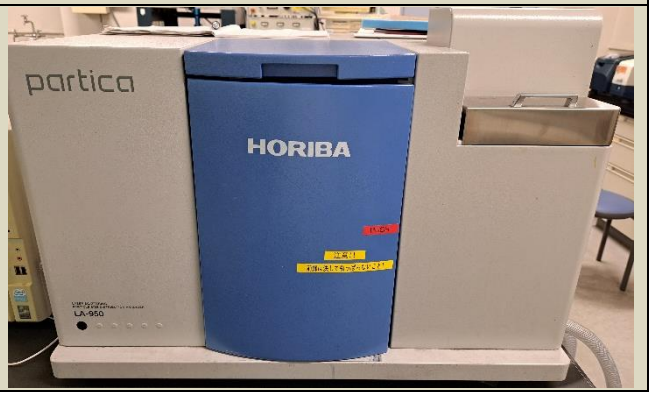

音叉振動式（SV 型）粘度計	SV-10A 株式会社エー・アンド・デイ製	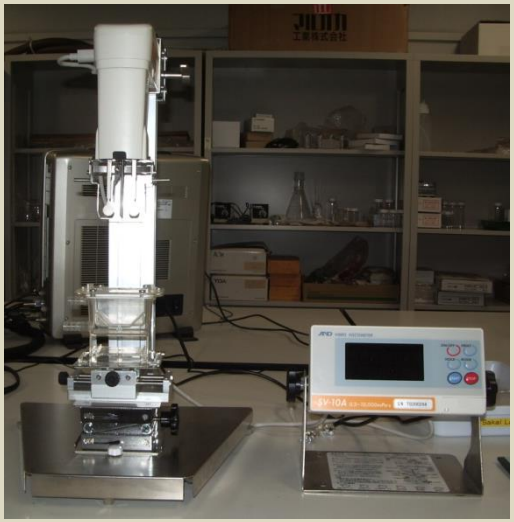
pH メーター	pH213 型卓上 pH 計 ハンナインスツルメンツ・ ジャパン株式会社製	

導電率計	Navi COND HORIBA 製	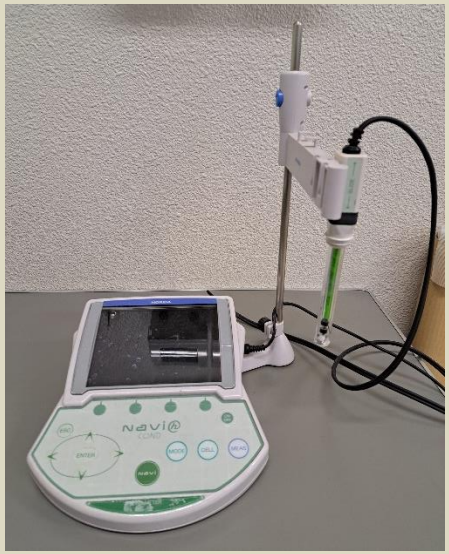

ローター式ホモジナイザー	CLEARMIX CLM-0.8S M TECHNIQUE 製 最高回転数 21,500 rmpm	
超音波洗浄器	FU-508CB アイワ医科工業製	

超音波洗浄機	28 kHz, 200 kHz, 950 kHz, 300 W 酒井俊郎製	
バブル発生装置	OM4-MDG-045(OG) AURA TEC 製	

スプレードライ装置	ADL311 ヤマト科学	

凍結乾燥機	FDU-1200 東京理化器機株式会社製	
角型真空乾燥器	FV0－10 Fine 製	

電気炉	FO310 yamato 製	
定温乾燥器	FO-60W　窓付 Fine 製	

卓上遠心機	H-28F コクサン製	
卓上遠心機		
超純水製造装置	Autopure WD501UV MILLIPORE 製	
電子天秤		

電子天秤 （使用不可）	AB265-S METTLER TOLEDO 製	
真空ガラスライン （使用不可）	10^{-6} Torr 高真空 幕張理化学硝子製作所製	